

『医用画像検査技術学 改訂4版』 正誤表

いつも小社出版物をご利用いただき誠にありがとうございます。

当該書籍に以下の誤りがございました。深くお詫びするとともにここに訂正いたします。

p.19 図 1-16. 説明文

【誤】

「患者を車椅子から検査台へ移すときの車椅子のつけ位置」

【正】

「患者を検査台から車椅子へ移すときの車椅子のつけ位置」

p.25 E-F の名称

【誤】

「人類学上基本線」

【正】

「人類学的基準線」

p.55 9行目

【誤】


「ら①大動脈, ②右心房,」

【正】


「ら①上大静脈, ②右心房,」

p.56 図 3-10

【誤】

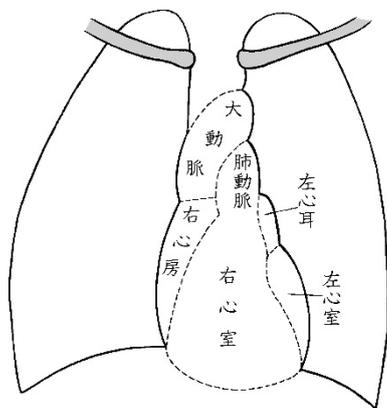


【正】

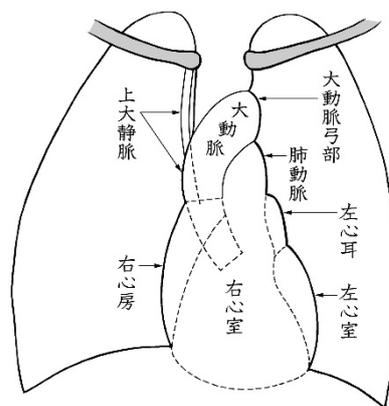


p.65 図 3-25

図の垂線は眼窩耳孔面を通るのが正しい.

【誤】

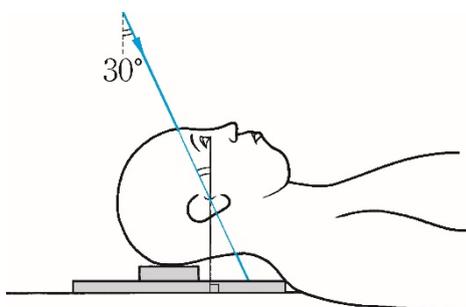

【正】

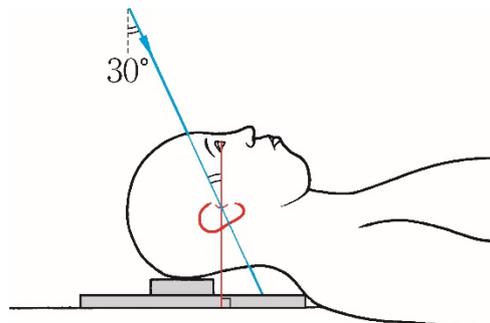

p.67 3行目

【誤】

「矢状面を非検側へ45°回旋し、」

【正】

「矢状面を**検側**へ45°回旋し、」

p.70 3行目


【誤】

「受像器に対して、眼窩耳孔面を40°」


【正】

「受像器に対して、**ドイツ水平面**を45°」

p.70 図 3-40 修正前

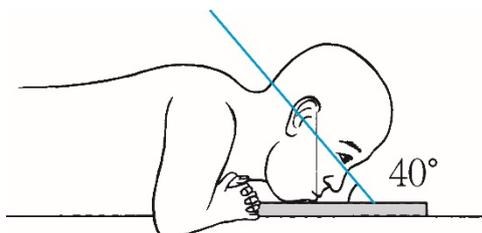

修正後

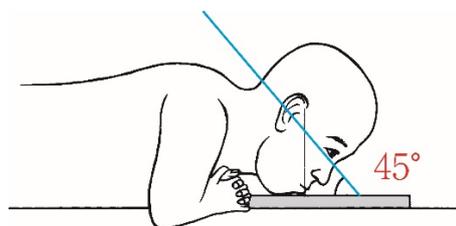

2023年5月現在